Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS

Armée suisse
Base logistique de l'armée BLA

Affaires sanitaires / Pharmacie de l'armée

N° 1/2012 Septembre 2012

Sommaire

Éditorial	1
Matériel sanitaire de décontamination NBC	2
Contrôle et maintenance des défibrillateurs (DAE)	3
Que faire si le formulaire de commande en ligne ne fonctionne pas ?	3
Fiches de données de sécurité pour les produits de la Pharmacie de l'armée disponibles en ligne en tout temps	5

Éditorial

Vous tenez entre vos mains le premier bulletin « Infos Pharm A » de l'année. Vous y trouverez, soigneusement rassemblées par mes collaborateurs, des informations actuelles qui devraient vous être utiles dans l'accomplissement de vos tâches quotidiennes.

Dans le cadre du projet d'optimisation de la distribution et de la restitution de matériel sanitaire, à la tête duquel se trouve actuellement Monsieur Christof Kropf (suppléant du chef du secteur Achats Pharm A), d'autres efforts seront consentis au cours de ces prochaines semaines dans le but d'améliorer la qualité des prestations que nous vous fournissons et de consolider les processus y relatifs.

Je vous souhaite plein succès dans votre travail ainsi qu'un agréable début d'automne.

Avec mes meilleures salutations,

Dr pharm. Heinz Moll
Pharmacien en chef de l'armée

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Infos Pharm A

N° 1/2012, septembre 2012

Département fédéral de la défense,
de la protection de la population et des sports
DDPS

Armée suisse
Base logistique de l'armée BLA / Affaires sanitaires

Matériel sanitaire de décontamination NBC

L'an dernier, le domaine Technique et production médicales a entrepris de revoir et compléter le matériel sanitaire de décontamination, aidé pour ce faire des responsables de troupe NBC (Spiez). Sept nouvelles pièces viennent ainsi compléter l'assortiment actuel. Il s'agit de matériel sanitaire employé par les troupes NBC pour la décontamination de personnes. Le tout se trouve stocké dans des superstructures interchangeables mobiles (*Wechselabrollbehälter*, WABRB) qui, pour toute intervention, peuvent être chargés à bord d'un camion à l'aide d'un système de crochets

Fig. 1 : Superstructure WABRB sur un camion

Le matériel sanitaire est composé, entre autres, des sept nouvelles pièces que voici :

- matériel de réanimation (appareil respiratoire, défibrillateur, etc.) ;
- moyens de décontamination, incl. flacons rince-œil et gel douche ;
- matériel de pansement ;
- solutions pour perfusion Ringer lactate ;
- matériel d'immobilisation, incl. minerve et bandes de fixation ;
- matériel à usage unique, sacs mortuaires, blouses et masques ;
- matériel à usage unique pour les injections (seringues et aiguilles).

Le matériel sanitaire comprend également un sac à dos d'urgence qui contient une bouteille de gaz comprimé Conoxia (2 l.) et un Ampullarium (set de médicaments).

Fig. 2 : Matériel sanitaire, WABRB 25.

Le matériel sanitaire est présenté de telle manière dans SAP qu'il est automatiquement inclu dans la commande lors d'une commande par la troupe, comme c'est le cas d'autres produits depuis l'introduction de Log@V.

Pharm A, Technique et production médicales
tony.muehlemann@vtg.admin.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Infos Pharm A

N° 1/2012, septembre 2012

Département fédéral de la défense,
de la protection de la population et des sports
DDPS

Armée suisse
Base logistique de l'armée BLA / Affaires sanitaires

Contrôle et maintenance des défibrillateurs (DAE)

La défibrillation est un moyen reconnu de mettre fin à des arythmies qui, si l'on n'intervient pas, peuvent se révéler fatales (p. ex. dans des cas de fibrillation ventriculaire). Un défibrillateur est un appareil permettant de délivrer un choc électrique au cœur au moyen d'électrodes placées au niveau de la cage thoracique.

Les collaborateurs de l'administration fédérale disposent en divers endroits de défibrillateurs automatisés externes (DAE). Les appareils fournis par la Pharmacie de l'Armée sont des modèles « Heartstart FR2 » et « Lifepak 1000 ».

Fig. 3 : Modèle «Heartstart FR2»

Fig. 4 : Modèle «Lifepak1000»

Nous attirons votre attention sur le fait que les défibrillateurs et le matériel qui s'y rapporte doivent régulièrement être contrôlés par l'utilisateur ou le responsable des appareils, et ce conformément aux instructions figurant dans le mode d'emploi. De cette manière, il est possible de s'assurer qu'en tout temps les appareils sont prêts à l'emploi. Les contrôles auxquels il est procédé sont inscrits sur des listes de contrôle fournies par la Pharmacie de l'armée avec chaque appareil. De telles listes sont désormais disponibles sur le site internet de la Pharmacie de l'armée également.

Lien (en allemand uniquement) :
http://www.lba.admin.ch/internet/lba/de/home/themen/armeeapotheke/kundeninformation/Bestellformulare.html

D'autres mesures ne doivent pas nécessairement être prises. Si vous remarquez des défectuosités ou qu'un message d'erreur apparaît sur l'écran, veuillez vous adresser à la Pharmacie de l'armée. Quant au matériel de remplacement, comme les batteries ou les électrodes, il peut être commandé au moyen des formulaires prévus à cet effet, que vous trouverez sous le lien ci-dessus.

Pharm A, Technique et production médicales
peter.mueller.mpr@vtg.admin.ch

Que faire si le formulaire de commande en ligne ne fonctionne pas ?

Si le formulaire de commande ne réagit pas au moment où vous désirez valider la commande (champ vert), il se peut que ce soit dû à un problème de sécurité des macros.

Vous pouvez y remédier comme suit :

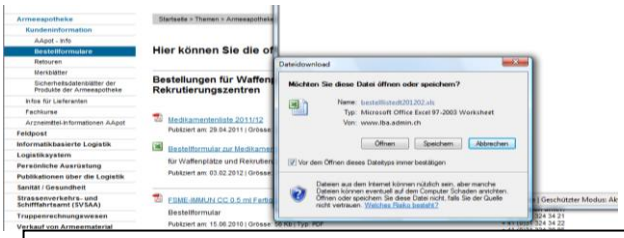

Ouvrir encore une fois le formulaire de commande (l'ouvrir, et non l'enregistrer).

Cliquer sur le bouton Office et sélectionner « Options Excel » (en bas à droite).

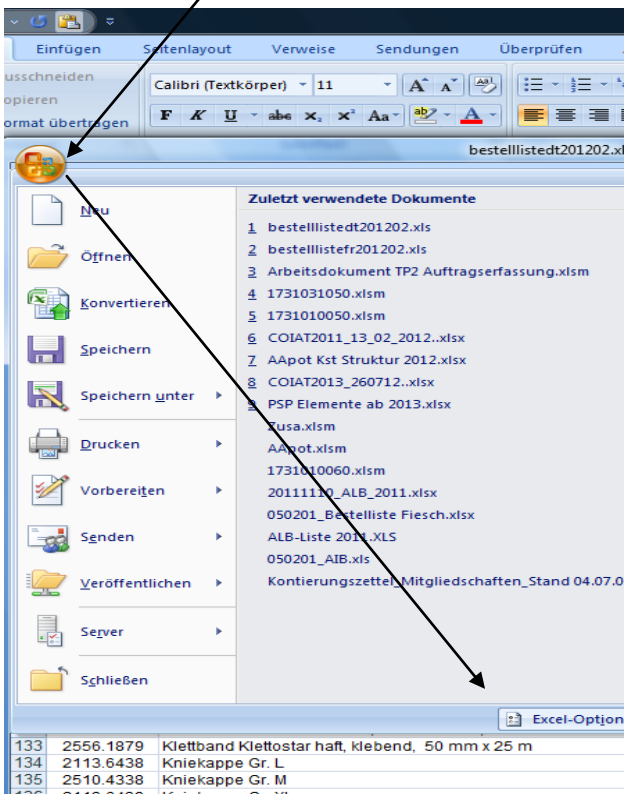

Aller sous « Standard », cocher la case « Afficher l'onglet Développeur dans le ruban » et cliquer sur « ok ».

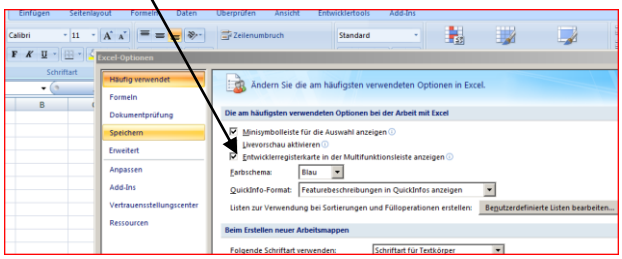

À l'ouverture du formulaire de commande, l'onglet « Développeur » apparaît alors dans le ruban. Dans l'onglet « Développeur », cliquer sur « Sécurité des macros » et changer les paramètres.

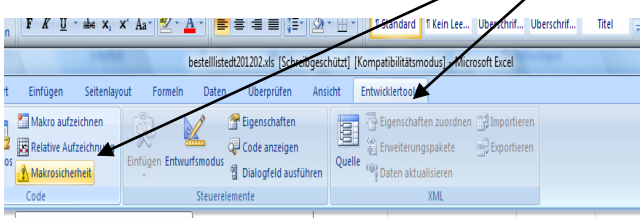

Pour que le formulaire de commande puisse être rempli et envoyé avec succès, la case « Activer toutes les macros (...) » doit être cochée.

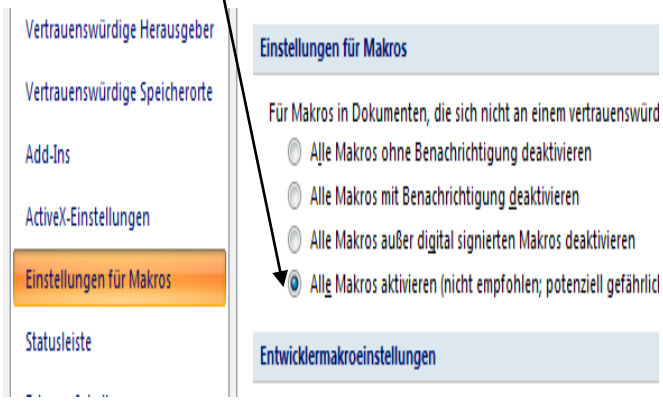

De tels paramètres ne doivent toutefois être sélectionnés que le temps de passer commande, et uniquement dans la mesure où vous rencontrez un problème avec le formulaire. Si le problème persiste, veuillez vous adresser à un spécialiste de la BAC.

Pharm A, Gestion de la clientèle
valerie.bader@vtg.admin.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Infos Pharm A

N° 1/2012, septembre 2012

Département fédéral de la défense,
de la protection de la population et des sports
DDPS

Armée suisse
Base logistique de l'armée BLA / Affaires sanitaires

Fiches de données de sécurité pour les produits de la Pharmacie de l'armée disponibles en ligne en tout temps

L'ordonnance sur les produits chimiques (OChim ; RS 813.11) prévoit à l'art. 52 que le fabricant établisse des fiches de données de sécurité (FDS) pour les produits qu'il fabrique. De telles fiches permettent de transmettre, pour diverses substances et préparations, des informations relatives à la sécurité. Elles visent à communiquer à l'utilisateur professionnel ou commercial les principales informations concernant ces diverses substances et préparations ainsi que des recommandations d'utilisation, cela afin que les mesures qui s'imposent puissent être prises en matière de protection de la santé, de sécurité sur le lieu de travail et de protection de l'environnement.

Les FDS des produits de la Pharmacie de l'armée sont disponibles depuis longtemps déjà dans SAP/ZID. Elles sont désormais également disponibles sur le site internet de la Pharmacie de l'armée, à l'adresse indiquée ci-contre.

Lien (en allemand uniquement) :
http://www.lba.admin.ch/internet/lba/de/home/themen/armeeapotheke/kundeninformation/sicherheitsdatenblaetter.html, sous « Sicherheitsdatenblätter AApot »

En cliquant sur « Sicherheitsdatenblätter AApot », vous arrivez sur le site internet de la BLA, dans la rubrique « Arbeitssicherheit und Umweltschutz », « Chemikalien ». Sous « Produkte der Armeeapotheke », vous pouvez choisir tant la langue que le produit que vous désirez. Une fois le fichier ZIP ouvert, vous pouvez accéder dans le dossier « Fiche données sécurité » à la fiche du produit qui vous intéresse (sous forme de fichier PDF).

Si vous avez des questions ou désirez des précisions, n'hésitez pas à me contacter.

Pharm A,
Technique et production pharmaceutiques
christina.bovard-reusser@vtg.admin.ch